

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-06-22

LAUDA Ultratemp UT 3505 W Termostato proceso
400 V; 3/PE; 50 Hz & 460 V; 3/PE; 60 Hz
N.º de pedido: L004025

Características de rendimiento

- Termostato de proceso con calefacción integrada
- LCD gráfico con guía de menú de texto legible
- Posibilidad de manejo mediante servidor web
- Interfaz Ethernet integrada
- Conexión de sensor de temperatura Pt100 externo
- Regulador constante totalmente electrónico con características PID
- Clase de protección IP 54 (para emplazamiento en el exterior)
- Carcasa de acero inoxidable
- Bomba monobloc industrial con alta presión y caudal elevado
- Bomba adicional para la circulación interna
- Indicador digital de la presión de la bomba
- Funcionamiento con líquidos no inflamables (agua, agua/glicol)
- Filtro de agua integrado
- Funcionamiento con refrigerante no inflamable (HFC), conforme con el Reglamento sobre los gases fluorados (UE) 573/2024
- Refrigeración del condensador por agua
- Certificación según UL 60335:2023, CSA C22.2 No. 60335 Ed. 2nd



Quedan reservadas las modificaciones técnicas



Temperatura de trabajo min.
-5 °C



Temperatura de trabajo max.
60 °C

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-06-22

LAUDA Ultratemp UT 3505 W Termostato proceso
400 V; 3/PE; 50 Hz & 460 V; 3/PE; 60 Hz
N.º de pedido: L004025

Características técnicas

Rango de temperatura de trabajo	-5 ... 60 °C
Rango de temperatura ambiente	-15 ... 50 °C
Estabilidad de temperatura	0,5 ± K
Potencia calorífica máx.	35 kW
Presión de elevación máx. 50 Hz	3,2 bar
Presión de elevación nominal 50 Hz	3 bar
Energía de elevación máx. (presión) 50 Hz	250 L/min
Presión de elevación máx. 60 Hz	4,6 bar
Energía de elevación máx. (presión) 60 Hz	300 L/min
Presión de elevación nominal 60 Hz	4,4 bar
Energía de elevación nominal bomba	90 L/min
Rosca de conexión de la entrada / salida (interior)	Rp 1 1/2
Refrigeración por agua rosca de conexión (interior)	Rp 1 1/2
Volumen de llenado máx.	100 L
Temperatura mín. del agua de refrigeración	0 °C
Temperatura máx. del agua de refrigeración	45 °C
Diferencia de presión del agua de refrigeración mín.	2 bar
Presión máxima del agua de refrigeración	6 bar
Consumo de agua de refrigeración	82,9 L/min
Refrigerante nivel 1	R-407C (GWP 1770); 3,200 kg; 5,7 t CO2-eq
Grado de protección	IP 54
Dimensiones (an x pr x al)	1138 x 1486 x 1792 mm
Peso	585 kg
Conector de red	---
Alimentación de red	400 V; 3/PE; 50 Hz & 460 V; 3/PE; 60 Hz
Máximo actual.	80 A

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-06-22

LAUDA Ultratemp UT 3505 W Termostato proceso
400 V; 3/PE; 50 Hz & 460 V; 3/PE; 60 Hz
N.º de pedido: L004025

Temperatura	Potencia de frío 50 Hz	Potencia de frío 60 Hz
60 °C	39,2 kW	45,8 kW
30 °C	39,2 kW	45,8 kW
20 °C	35,3 kW	41,1 kW
15 °C	30,5 kW	35,5 kW
10 °C	26,2 kW	29,4 kW
5 °C	22 kW	25,6 kW
0 °C	18,7 kW	21,7 kW
-5 °C	15,1 kW	17,5 kW

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser


HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-06-22

LAUDA Ultratemp UT 3505 W Termostato proceso
400 V; 3/PE; 50 Hz & 460 V; 3/PE; 60 Hz
N.º de pedido: L004025

CURVAS CARACTERÍSTICAS DE LAS BOMBAS 50 Hz Líquido caloportador: Agua

Presión bar

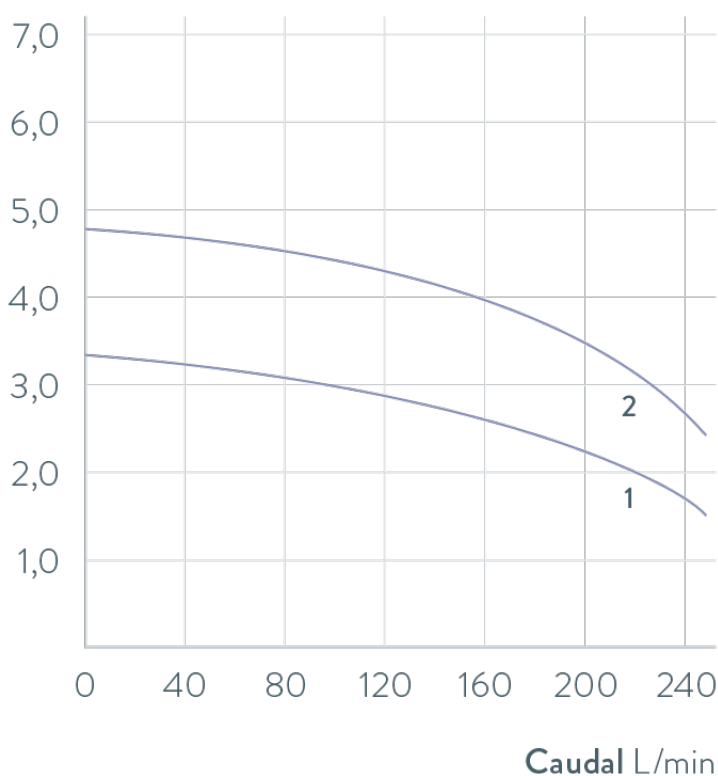

2 UT 5005 W

1 UT 2505 W, UT 3505 W

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069


Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Stand: 2026-06-22

LAUDA Ultratemp UT 3505 W Termostato proceso
400 V; 3/PE; 50 Hz & 460 V; 3/PE; 60 Hz
N.º de pedido: L004025

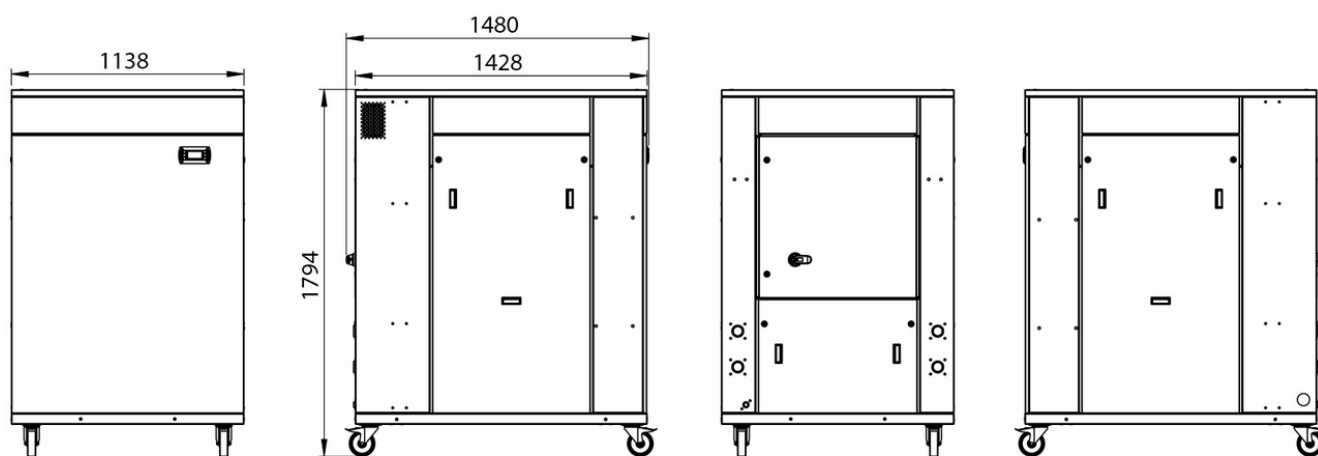

Quedan reservadas las modificaciones técnicas

LAUDA DR. R. WOBSEY GMBH & CO. KG
Laudaplatz 1 • 97922 Lauda-Königshofen • DE

T + 49 (0) 9343 503-0
info@lauda.de • www.lauda.de
WEEE-Reg-Nr.: DE 66 42 40 57

Kommanditgesellschaft: Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRA 560069

Persönlich haftende Gesellschafterin:
LAUDA DR. R. WOBSEY Verwaltungs-GmbH
Sitz Lauda-Königshofen
Registergericht Mannheim • HRB 560226

Geschäftsführer:
Dr. Gunther Wobser (Vors.), Dr. Mario Englert,
Dr. Marc Stricker
Beirat: Dr. Gerhard Wobser